



Meditech Europe



Blood optimizer

user manual

Blood optimizer



By using the device for about 8 to 20 minutes a day, for three or four weeks, more than 95% of the endemic HIV virus would be effectively neutralised, he said.

For severe infections, shorter application times can avoid overloading the patient with toxins. To still achieve the same result, the treatment can be spread over more days. In time, the recovered immune system can repair the remaining problems itself. If there is a weakened blood circulation, due to diabetes, a longer treatment period is recommended. The released toxins can leave the body naturally through the kidneys or liver. Drinking plenty of water is recommended. Faster degradation is possible, but not recommended due to the Herxheimer reaction. This occurs when the body detoxifies too quickly and releases more toxins than the body can eliminate.

Latent or germinating HIV reservoirs in the tissue fluid or in other tissues of the body can theoretically be destroyed with a second device. This is done by means of a magnetic pulse of > 35 joules with a very high intensity (several kilogauss) for a very short time.

The physics of vortex currents should make it easy to induce the minimum current of about 50 to 100 μA through infected tissue. Several pulses at each site will provide a reliable "overkill" for successful HIV neutralisation. A magnetic "pulsar" is very easy to operate.

Usage:


Place the electrode straps on the inside of your left wrist or your left ankle, with the electrodes on the skin.

Connect the cables to the connectors at the top of the Blood optimizer.

Switch on the Blood optimizer

Now slowly turn the dial clockwise. Do this until you feel a soft tingle on the skin. Turn the dial back slightly until the tingling sensation is comfortable.

NOTE: The Blood Optimizer must be experienced as pleasant. If the tingling is too strong, the Blood optimizer is not set correctly and the dial should be turned back until the sensation is comfortable.

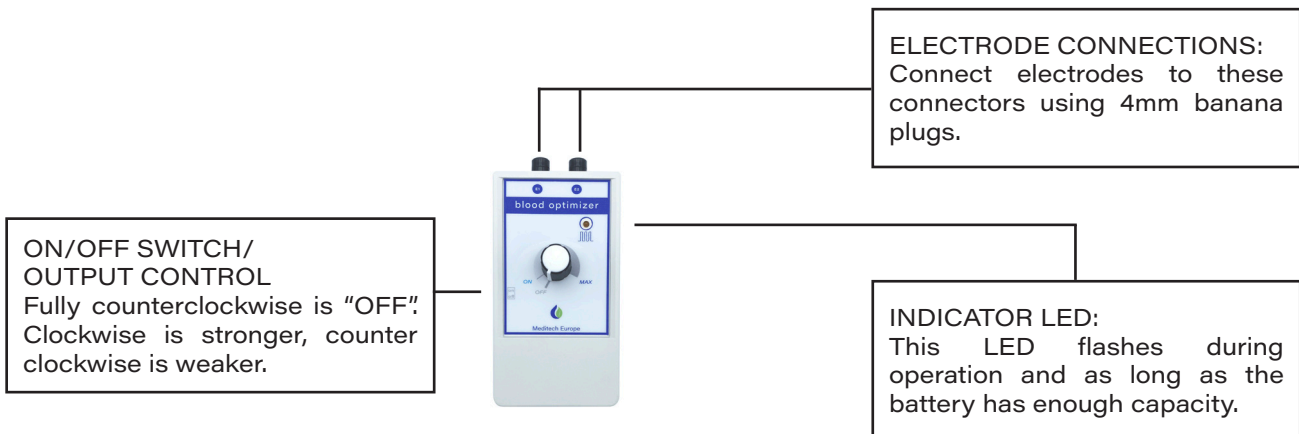

Specifications:

Power supply:	9V battery or NICAD accumulator
Output frequency:	Approximately 2 Hz AC
Supply current(max):	25mA (Output control fully clockwise)
Output voltage:	Counterclockwise approx 8V Clockwise approx 27V
Led indicator:	Energy saving LED flashes during operation

Blood optimizer



Wenn man das Gerät drei bis vier Wochen lang täglich 8 bis 20 Minuten lang benutze, würden mehr als 95 % des endemischen HIV-Virus wirksam neutralisiert, sagte er.


Bei schweren Infektionen kann durch kürzere Anwendungszeiten eine Überlastung des Patienten mit Toxinen vermieden werden. Um das gleiche Ergebnis zu erzielen, kann die Behandlung auf mehrere Tage verteilt werden. Mit der Zeit kann das wiederhergestellte Immunsystem die verbleibenden Probleme selbst beheben. Bei einem geschwächten Blutkreislauf aufgrund von Diabetes wird eine längere Behandlungsdauer empfohlen. Die freigesetzten Giftstoffe können den Körper auf natürliche Weise über die Nieren oder die Leber verlassen. Es wird empfohlen, viel Wasser zu trinken. Ein schnellerer Abbau ist möglich, wird aber wegen der Herxheimer-Reaktion nicht empfohlen. Dies geschieht, wenn der Körper zu schnell entgiftet und mehr Giftstoffe freisetzt, als der Körper ausscheiden kann.

Latente oder keimende HIV-Reservoirs in der Gewebeflüssigkeit oder in anderen Geweben des Körpers können theoretisch mit einem zweiten Gerät zerstört werden. Dies geschieht durch einen magnetischen Impuls von > 35 Joule mit einer sehr hohen Intensität (mehrere Kilogauss) für eine sehr kurze Zeit.

Die Physik der Wirbelströme sollte es leicht machen, den Mindeststrom von etwa 50 bis 100 μA durch infiziertes Gewebe zu induzieren. Mehrere Pulse an jeder Stelle sorgen für einen zuverlässigen "Overkill" für eine erfolgreiche HIV-Neutralisierung. Ein magnetischer "Pulsar" ist sehr einfach zu bedienen.

Verwendung:

- Legen Sie die Elektrodenbänder an der Innenseite des linken Handgelenks oder des linken Knöchels an, so dass die Elektroden auf der Haut liegen.
- Verbinden Sie die Kabel mit den Anschlüssen an der Oberseite des Blutoptimierers.
- Schalten Sie den Blood Optimizer ein
- Drehen Sie nun das Rad langsam im Uhrzeigersinn. Tun Sie dies, bis Sie ein leichtes Kribbeln auf der Haut spüren. Drehen Sie den Regler leicht zurück, bis das Kribbeln als angenehm empfunden wird.
- HINWEIS: Der Blood Optimizer muss als angenehm empfunden werden. Wenn das Kribbeln zu stark ist, ist der Blutoptimierer nicht richtig eingestellt und der Regler sollte zurückgedreht werden, bis das Gefühl angenehm ist.

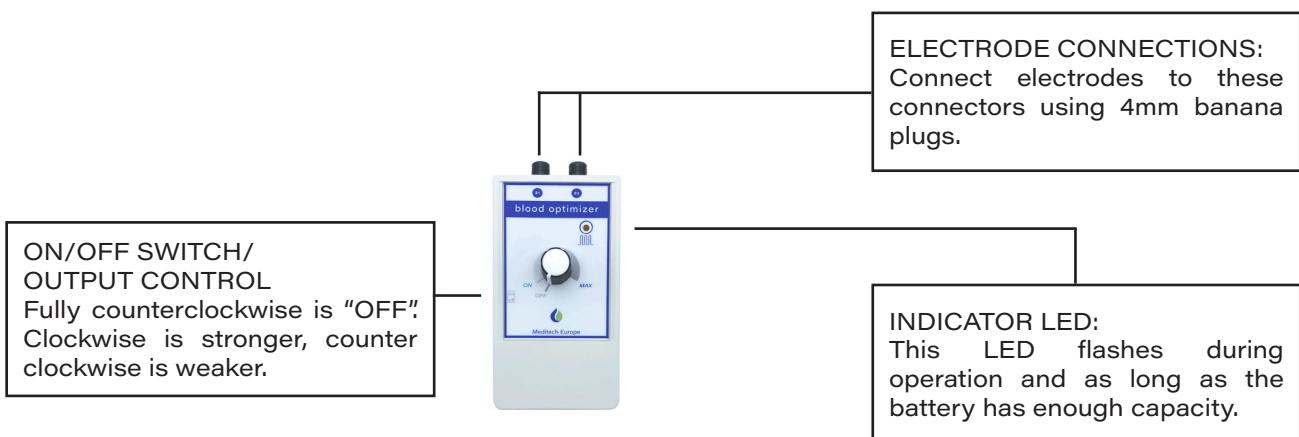

Spezifikationen:

Stromversorgung:	9V-Batterie oder NICAD-Akku
Ausgangsfrequenz:	Ungefähr 2 Hz AC
Versorgungsstrom (max):	25mA (Ausgangsregler voll im Uhrzeigersinn)
Ausgangsspannung:	Gegen den Uhrzeigersinn ca. 8V Im Uhrzeigersinn ca. 27V
LED-Anzeige:	Energiespar-LED blinkt während des Betriebs




Blood optimizer



Door het apparaat ongeveer 8 tot 20 minuten per dag te gebruiken, gedurende drie of vier weken, zou meer dan 95% van het endemische HIV-virus effectief geneutraliseerd worden, aldus de auteur. Voor ernstige infecties kan door kortere toepassingstijden worden voorkomen dat de patiënt met toxines wordt overladen. Om toch hetzelfde resultaat te bereiken, kan de behandeling over meer dagen plaatsvinden. Na verloop van tijd kan het herstelde immuunsysteem de resterende problemen zelf herstellen. Als er sprake is van een verzwakte bloedsomloop, als gevolg van diabetes, is een langere behandelingsduur aan te bevelen. De vrijgekomen gifstoffen kunnen het lichaam op natuurlijke wijze verlaten via de nieren of de lever. Het drinken van veel water wordt aangeraden. Een snellere afbraak is mogelijk, maar niet aan te raden vanwege de Herxheimer-reactie. Deze treedt op wanneer het lichaam te snel ontgift en er daardoor meer gifstoffen vrijkomen dan het lichaam kan uitscheiden. Latente of kiemende HIV-reservoirs in de weefselvloeistof of in andere weefsels van het lichaam kunnen theoretisch met een tweede apparaat worden vernietigd. Dit gebeurt door middel van een magnetische puls van > 35 joule met een zeer hoge intensiteit (enkele kilogauss) gedurende een zeer korte tijd. De fysica van vortexstromen zou het gemakkelijk moeten maken om de minimale stroom van ongeveer 50 tot 100 μA door geïnfecteerd weefsel te induceren. Verscheidene pulsen op elke plaats zullen een betrouwbare "overkill" opleveren voor een succesvolle HIV-neutralisatie. Een magnetische "pulsar" is zeer gemakkelijk te bedienen.

Gebruik:

- Plaats de elektrodenbandjes op de binnenzijde van uw linker pols of uw linker enkel, met de elektroden op de huid.
- Sluit de kabels aan op de connectoren aan de bovenzijde van de Blood optimizer.
- Schakel de Blood optimizer aan
- Draai nu langzaam de draaiknop rechtsonder. Doe dit tot u een zacht geprikkelde gevoel op de huid. Draai de draaiknop iets terug totdat het prikkelende gevoel aangenaam is.
- LET OP: de Blood optimizer dient aangenaam te worden ervaren. Als de prikkeling te heftig is, is de Blood optimizer niet goed ingesteld en dient de draaiknop te worden terug gedraaid, net zo lang tot het gevoel goed is.

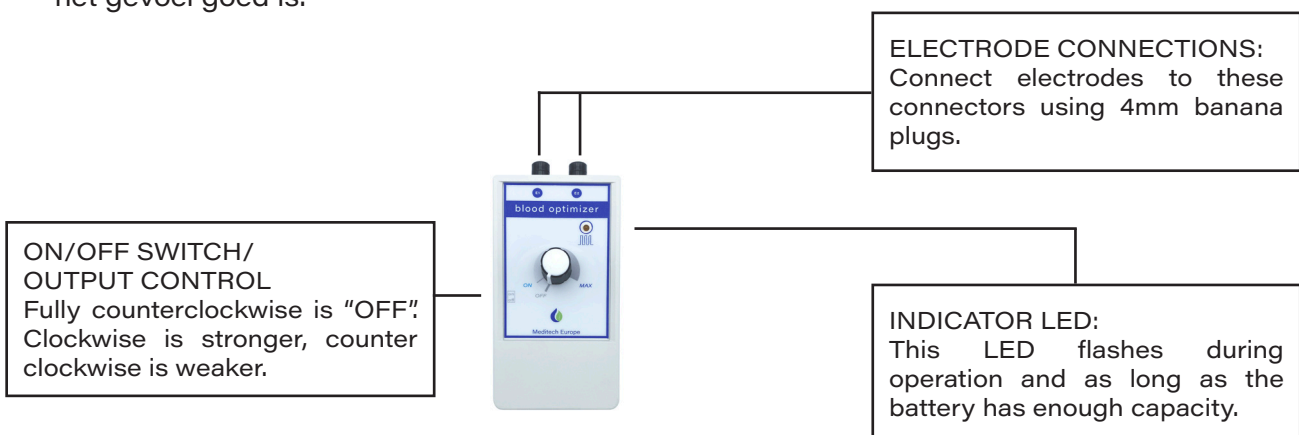

Specificaties:

Stroomvoorziening:	9V batterij of NICAD accu
Uitgangsfrequentie:	Ongeveer 2 Hz AC
Voedingsstroom (max):	25mA (Uitgangscntrole volledig rechtsonder)
Uitgangsspanning:	Tegen de klok in ongeveer 8V Met de klok mee ongeveer 27V
Led-indicator:	Energiebesparende LED knippert tijdens gebruik

Map of Blood Vessels in Extremities for Optimum Electrode Access

Gray's Anatomy pgs. 540, 541, 584, 591

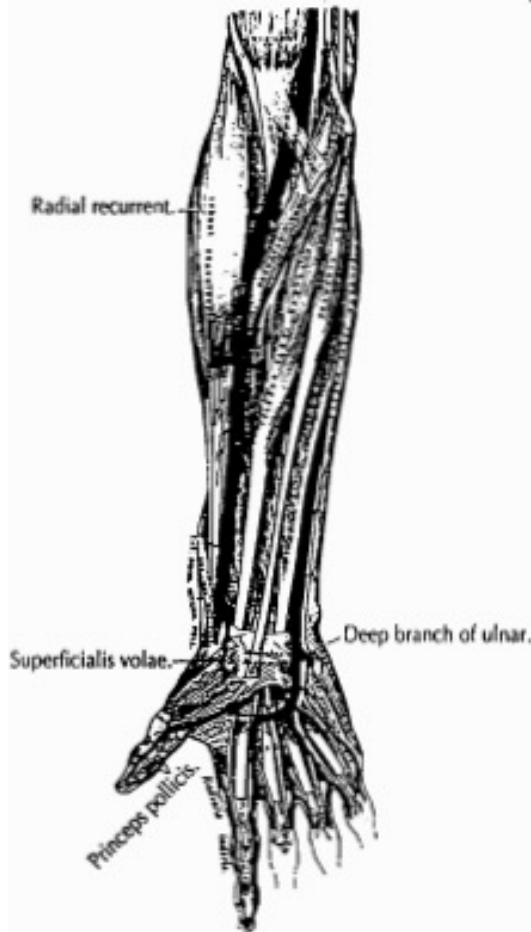


Fig. 304.—The radial and ulnar arteries.

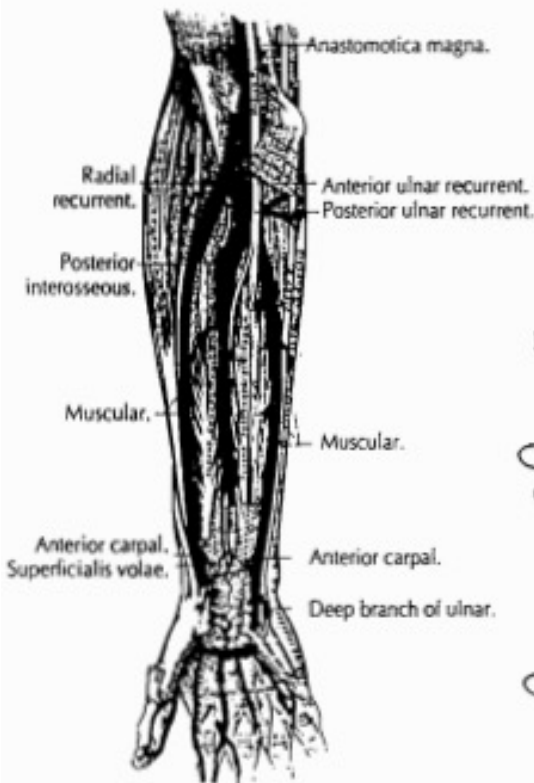


Fig. 305.—Ulnar and radial arteries. Deep view.


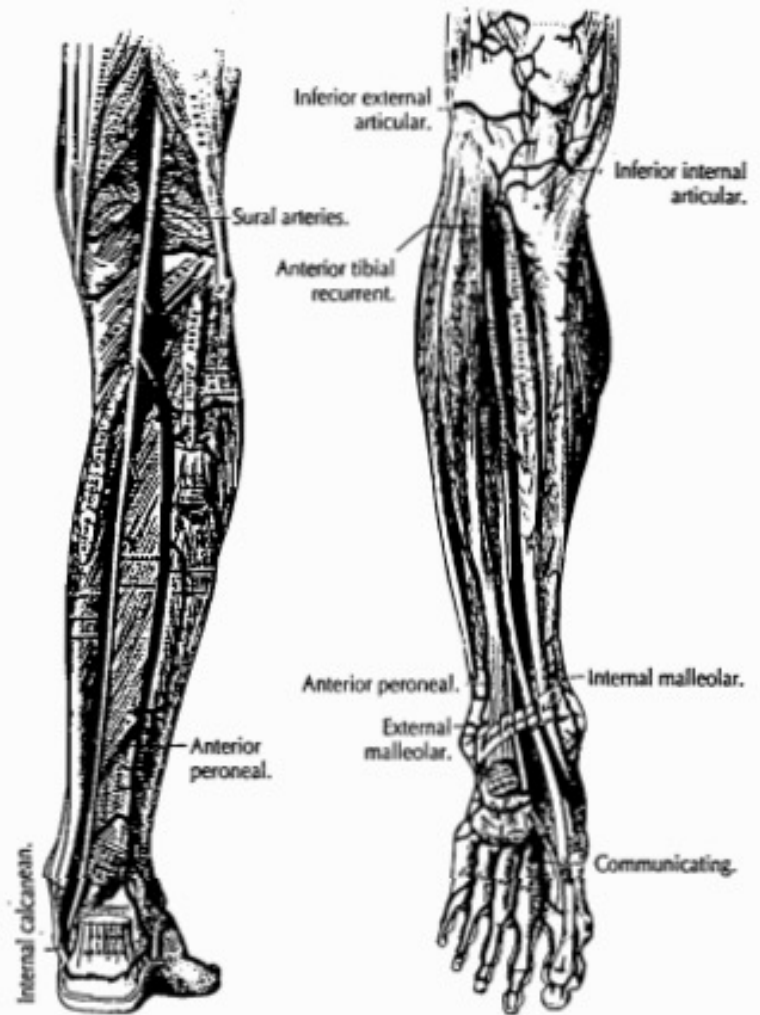


Fig. 320.—The popliteal, posterior tibial, and peroneal arteries.

Fig. 321.—Surgical anatomy of the anterior tibial and dorsalis pedis arteries.

PLACEMENT OF PROBES (ELECTRODES): Over *Arteries* not blue veins.

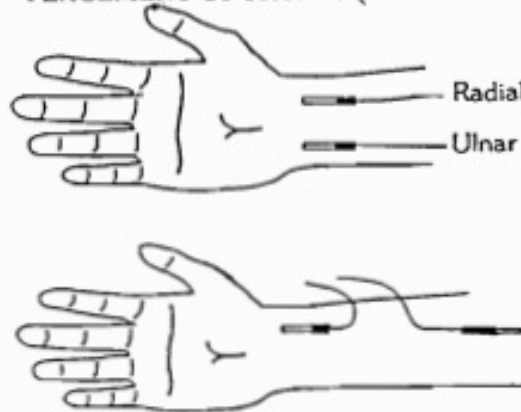

Align Electrodes Parallel to Pulse and Directly Over Pulse Paths

The figure illustrates the hypothetical placement of the two electrodes on the same wrist. It is easier to place the electrodes if you first place the strap around the wrist and then insert the electrodes under the strap.

This figure illustrates the hypothetical placement of the two electrodes on the same forearm and wrist. Position probes about 6" apart on same Radial Artery.

Choose from Two Ways to Align Probes Parallel to Pulse





Meditech Europe

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

+31 527 292331

info@meditecheurope.nl

www.meditecheurope.nl